





JETZT ANSEHEN
auf YouTube!

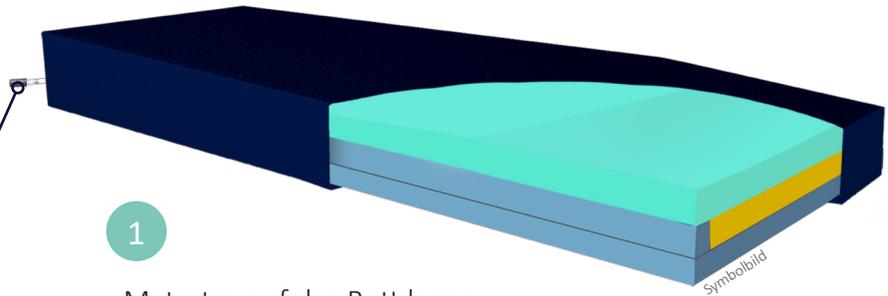

1

Matratze auf das Bett legen.
Bitte beachten Sie den Aufdruck
„THIS SIDE UP“.

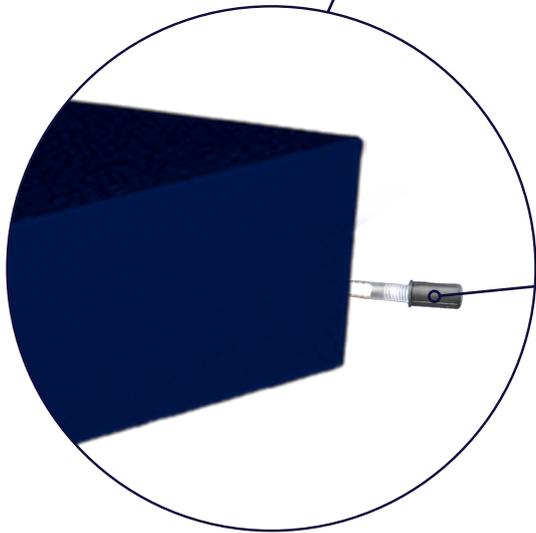

2

Ventil durch Ziehen öffnen und
ca. 5 Minuten warten, bis sich
die Luftzellen selbstständig
aufgeblasen haben.

(Ventilkappe kann nicht herunterfallen.)

3

Ventil durch
Drücken schließen.

4

Legen Sie den Patienten auf die
Matratze. Öffnen Sie vorsichtig das
Ventil durch Ziehen der grauen Kappe,
damit Luft entweicht und führen Sie
gleichzeitig einen Fingertest* durch.

**Führen Sie eine Hand unter das Gesäß. Der
optimale Liegekomfort ist erreicht, wenn nur
noch eine geringe Fingerbewegung von
1 – 2,5 cm möglich ist.*

5

Ventil durch
Drücken schließen.

6

Tägliche Überprüfung der richtigen
Befüllung der Luftkammern wird
empfohlen, ggf. ist eine Anpassung
notwendig.